


Złożenie wniosku o ocenę zgodności przyrządów pomiarowych – moduł A2

Otwórz stronę główną systemu Świtez adres: <https://switez.gum.gov.pl/>

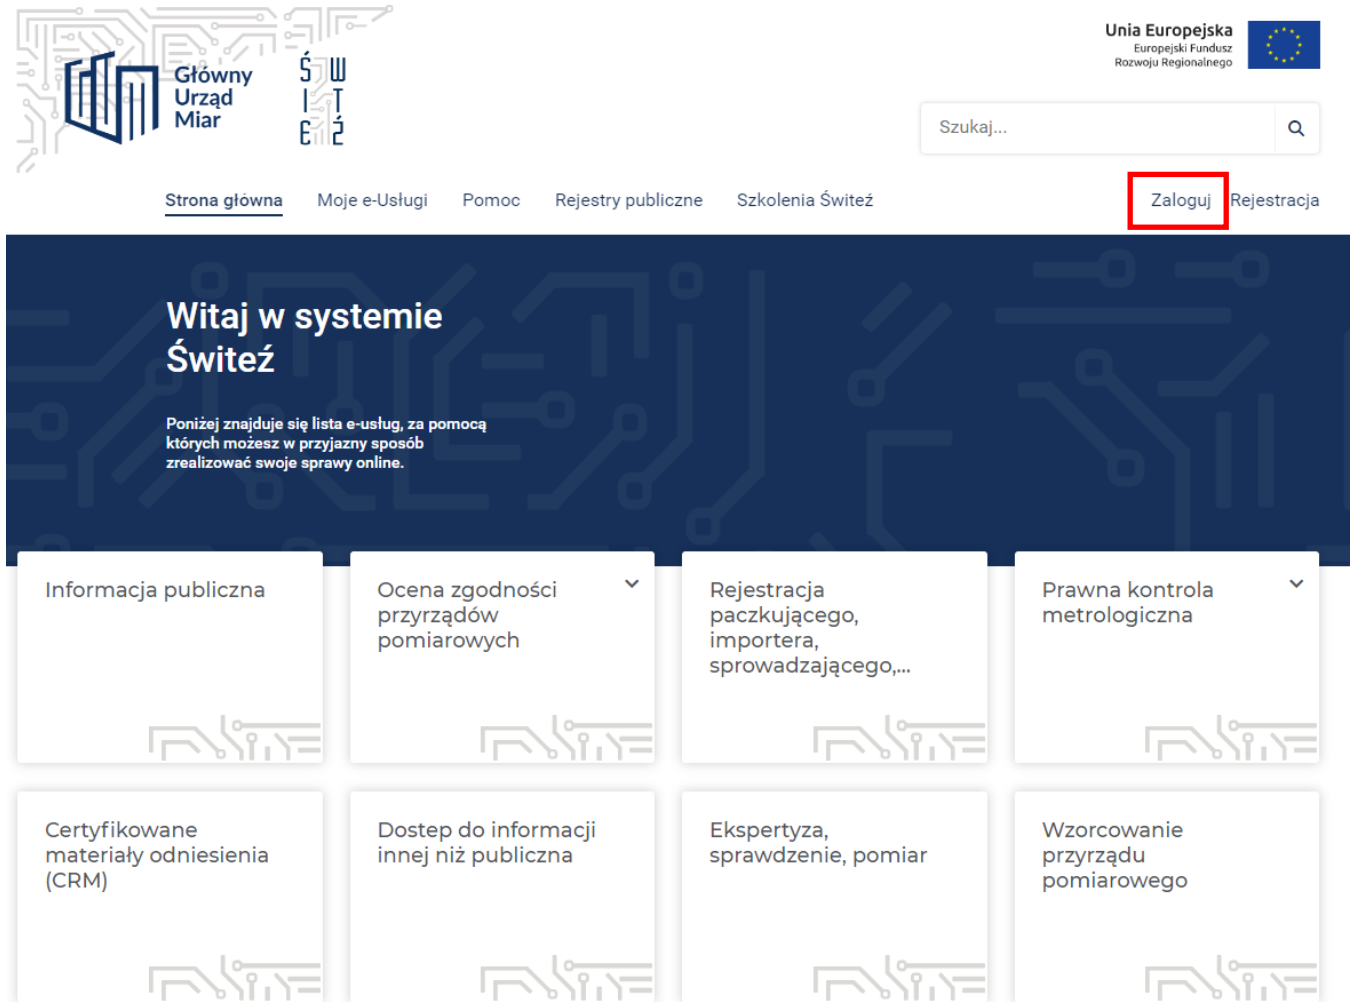

1. Naciśnij przycisk **Zaloguj** a następnie wybierz sposób logowania do systemu.

Wybierz sposób logowania:

Węzeł Krajowy

Wybierz tę metodę, jeżeli chcesz się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub narzędzia mojejID

Wybierz

Certyfikat Kwalifikowany

Wybierz tę metodę, jeżeli chcesz się zalogować za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego


Wybierz

Zaloguj loginem i hasłem


2. Wygaśnięcie sesji następuje po 15 minutach bezczynności systemu ŚWITEŻ. System informuje o czasie pozostałym do końca sesji.

The screenshot displays the ŚWITEŻ system interface. At the top left is the logo of the Główny Urząd Miar (GUM) and the ŚWITEŻ logo. To the right are the logos for the Unia Europejska (European Union) and the Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund). A search bar labeled 'Szukaj' is present. Below the search bar, a red-bordered box highlights a notification: 'To jest czas do końca sesji. Kliknij, aby przedłużyć o 15 minut'. Below this notification, the user's name 'Karol Rogacki' and a clock icon showing '12:10' are visible. The main navigation bar includes links: 'Strona główna', 'Moje e-Usługi', 'Pomoc', 'Rejestry publiczne', and 'Szkolenia Świteż'. The main content area features a dark blue header with the text 'Witaj w systemie Świteż' and a sub-header: 'Poniżej znajduje się lista e-usług, za pomocą których możesz w przyjazny sposób zrealizować swoje sprawy online.' Below this, there is a grid of eight service tiles, each with a circuit-like icon at the bottom: 'Informacja publiczna', 'Ocena zgodności przyrządów pomiarowych', 'Rejestracja paczkującego, importera, sprowadzającego,...', 'Prawna kontrola metrologiczna', 'Certyfikowane materiały odniesienia (CRM)', 'Dostęp do informacji innej niż publiczna', 'Ekspertyza, sprawdzenie, pomiar', and 'Wzorcowanie przyrządu pomiarowego'.

3. Po zalogowaniu wybranym sposobem (np. węzeł krajowy, certyfikat kwalifikowany) ze strony głównej systemu wybierz kafelkę „Ocena zgodności przyrządów pomiarowych”.

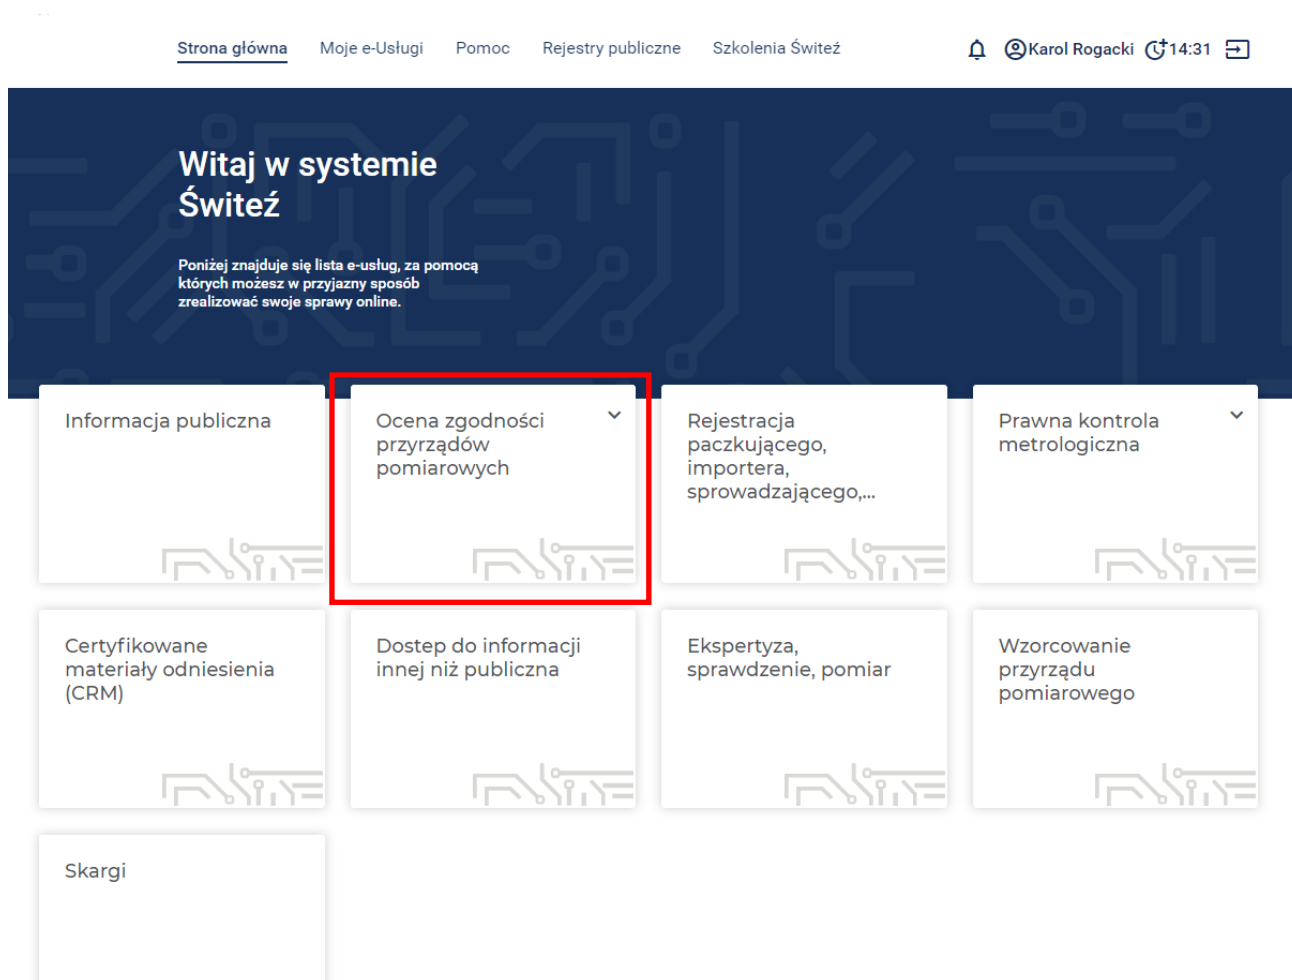

4. W następnym kroku wybierz moduł oceny zgodności (w tym przypadku moduł A2).

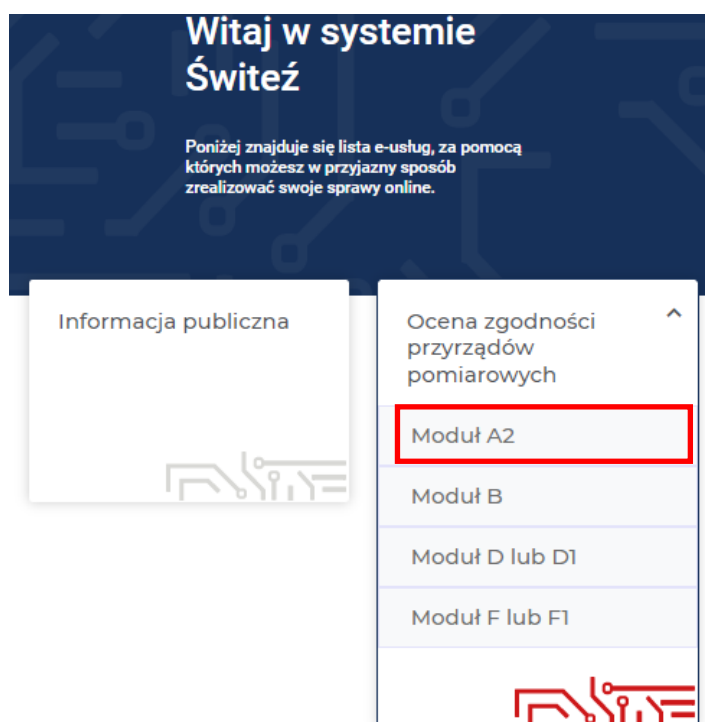

5. Po wyborze modułu, zostaje wyświetlona strona z opisem wybranego modułu oceny zgodności wraz z informacją o wymaganych dokumentach.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2 (wewnętrzna kontrola produkcji i nadzorowana kontrola wyrobów w losowych odstępach czasu)

Opis skrócony

Producent przyrządów pomiarowych lub jego upoważniony przedstawiciel może wnioskować o przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami w losowych odstępach czasu w celu weryfikacji jakości wewnętrznej kontroli produkcji przez wybraną Jednostkę Notyfikowaną. Moduł A2 dotyczy wyłącznie miar materialnych - naczyń wyszynkowych (Dyrektywa MID / MI-008).

Wymagane dokumenty

Klient składa Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności naczyń wyszynkowych wraz z ich dokumentacją techniczną. Na podstawie wniosku pracownik urzędu przygotowuje i wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia - umowę o stałej współpracy, którą Klient powinien podpisać i odesłać żeby zrealizować usługę.

Odbiorca usługi

Producent, Upoważniony przedstawiciel

Termin załatwienia sprawy

Termin realizacji sprawy jest każdorazowo wyznaczany przez upoważnionego pracownika urzędu i wynika z aktualnych możliwości i zasobów laboratorium.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji urzędu odbywa się zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie <https://krakow.gum.gov.pl> i Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi <https://lodz.gum.gov.pl>

Załatw sprawę

Opis skrócony

Wymagane dokumenty

Odbiorca usługi

Termin załatwienia sprawy

Sposób odwołania

Opłaty

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

Kategorie życiowe

Słowa kluczowe

6. Następnie wybierz zielony przycisk **Załatw sprawę**.
7. Wybierz jednostkę do której kierowany jest wniosek aby zrealizować usługę.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2 (wewnętrzna kontrola produkcji i nadzorowana kontrola wyrobów w losowych odstępach czasu)

← Wróć do karty usługi

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:

Jednostka	Miejscowość
<input type="radio"/> OUM Kraków	Kraków ▼
<input type="radio"/> OUM Łódź	Łódź ▼

8. Mając wybraną jednostkę wybierz sposób załatwienia sprawy.

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:

<p>Załatw sprawę przez portal</p> <p>Wybierz</p>	<p>Załatw sprawę w urzędzie</p> <p>Wybierz</p>
--	--

9. Jeśli chcesz uzupełnić a następnie wysłać wniosek przez system Świtez nacisnij przycisk **Wybierz** (Załatw sprawę przez portal). Wybór opcji „Załatw sprawę w urzędzie” umożliwia wypełnienie wniosku a następnie jego wydruk i dostarczenie do urzędu.

10. Następnie w kroku 3 zaznacz tytuł formularza wniosku oraz nacisnij zielony przycisk **Wypełnij elektronicznie**.

Krok 3: Wybierz wniosek:

Tytuł formularza:

☒ Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

Wypełnij elektronicznie

11. Wypełniając wniosek w górnej części ekranu, jest możliwość podglądu na którym kroku wypełniania wniosku jesteś oraz widok ile kroków pozostało do końca wypełnienia i wysłania wniosku.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

1. Dane ogólne

12. W części „Dane wnioskodawcy” wybierz typ wnioskodawcy (producent lub upoważniony przedstawiciel producenta) a następnie uzupełnij lub ewentualnie sprawdź dane, które w przypadku posiadania konta w systemie przenoszą się automatycznie.

Uwaga – pola w systemie oznaczone * są konieczne do uzupełnienia.

Dane wnioskodawcy

Dane podstawowe

Typ wnioskodawcy *		Nazwa podmiotu *	
<div><input type="text"/></div> <div>Producent Upoważniony przedstawiciel producenta</div>		REGION	
Telefon		KRS	
Fax		Adres e-mail interesanteurad3@gmail.com	
Adres stały			
Ulica Jasna		Nr budynku *	Nr lokalu
Kod pocztowy * 12-456		Miejscowość * Leszno, woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno	
Skrytka pocztowa		Kraj *	Polska

Adres korespondencyjny

☐ Taki sam jak "Adres stały"

13. Po uzupełnieniu ww. pól można wybrać przycisk **Zapisz kopię roboczą** (dostępny na większości kroków). Jeśli chcesz przejść do następnego kroku wypełniania wniosku należy nacisnąć przycisk **Dalej**.

Zapisz kopię roboczą

Dalej

14. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** w drugim kroku wypełniania wniosku „**Dane dodatkowe**” należy wprowadzić dane związane z osobą do kontaktu w sprawie realizacji wniosku.

W polu „**Informacje dodatkowe**” można wybrać z listy rozwijalnej sposób dojazdu pracowników, oraz wpisać inne informacje w polu „**Uwagi**”.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

2. Dane dodatkowe

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie

Dane podstawowe

Imię	Nazwisko
Stanowisko/funkcja	Adres e-mail
Telefon	Fax

Informacje dodatkowe

Dojazd pracowników Jednostki Notyfikowanej

Uwagi

Wstecz


Zapisz kopię roboczą

Dalej

15. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** w kroku 3 wypełniania wniosku „**Zgłoszone przyrządy pomiarowe**” wprowadź dane dotyczące przyrządów pomiarowych w odniesieniu do których ma być przeprowadzona ocena zgodności.

16. Aby zgłosić przyrząd pomiarowy do oceny zgodności naciśnij zielony przycisk **Dodaj**.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2



3. Zgłoszone przyrządy pomiarowe

Zgłoszone przyrządy pomiarowe

Nazwa naczynia wyszynkowego

Nazwa handlowa

Model

Materiał

Brak wyników do wyświetlenia

Dodaj

Wstecz

Zapisz kopię roboczą

Dalej

17. Zostaje otwarta karta związana z przyrządem pomiarowym.

18. Z listy rozwijalnej wybierz nazwę naczynia wyszynkowego. Następnie wypełnij pola związane z typem przyrządu, modelem, współczynnikiem rozszerzalności cieplnej itp.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

Nowy przyrząd pomiarowy

Nazwa naczynia wyszynkowego *

Materialne miary - naczynia wyszynkowe krawędziowe A2

Naczynia wyszynkowe z dwiema kresami oznaczającymi pojemności nominalne, moduł A2

Naczynia wyszynkowe z jedną kresą oznaczającą pojemność nominalną, moduł A2

Naczynia wyszynkowe z trzema

Nazwa handlowa

Oznaczenie spoza listy

Materiał

Liczność partii produkcji *

Anuluj Zapisz i skopiuj Zapisz i dodaj nowy Zapisz i zamknij

Nazwa naczynia wyszynkowego

Dodaj

Wstecz Zapisz kopię roboczą Dalej

3. Zgłoszone przyrządy pomiarowe

Zgłoszone przyrządy pomiarowe

Nazwa naczynia wyszynkowego *

Naczynia wyszynkowe z jedną kresą oznaczającą pojemność nominalną, moduł A2

Oznaczenie (typ) lub nazwa producenta

Model

Szklanka

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

1

Miejsce pobrania próbki

Dostarczenie przyrządu pomiarowego przez Zleceniodawcę

Nazwa handlowa

Szklanka

Oznaczenie spoza listy

AQ

Materiał

Szkło

Liczność partii produkcji *

1000

Anuluj Zapisz i skopiuj Zapisz i dodaj nowy Zapisz i zamknij

Nazwa naczynia wyszynkowego

Dodaj

Wstecz

Główny Urząd Miar
ul. Elekoralna 2
00-139 Warszawa
tel.: 22 581 93 99
fax.: 22 581 93 92

główna strona
problem działania serwisu
Polityka prywatności

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2



Zgłoszone przyrządy pomiarowe

Nazwa naczynia wyszynkowego	Nazwa handlowa	Model	Materiał	
Naczynia wyszynkowe z jedną kresą oznaczającą pojemność nominalną, moduł A2	Szklanka	Szklanka	Szkło	<div><div>Szczegóły</div><div>Edytuj</div><div>Usuń</div></div>

Dodaj

Wstecz

Zapisz kopię roboczą

Dalej

24. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** przejdziesz do 4 kroku wypełniania wniosku „**Załączniki**”.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

Załączniki

Lp.	Nazwa załącznika	Plik załącznika	Status
<div>Dodaj załącznik</div>			

Wstecz


Zapisz kopię roboczą

Dalej

25. Dodanie załącznika następuje poprzez przycisk **Dodaj załącznik**. Dodając załącznik należy określić jego nazwę.

26. Dodanie pliku do załącznika następuje poprzez przycisk **Dodaj plik**.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2



Załączniki


Lp.	Nazwa załącznika	Plik załącznika ⓘ	Status
1	Załącznik testowy	<div>Dodaj plik</div>	Brak pliku <input type="radio"/>

Dodaj załącznik

Wstecz


Zapisz kopię roboczą

Dalej

27. Po dodaniu załącznika a następnie naciśnięciu przycisku  istnieje możliwość wyboru **Edytuj nazwę** wówczas możesz zmienić nazwę dodanego załącznika.

W przypadku wyboru funkcji **Usuń załącznik** istnieje możliwość usunięcia dodanego załącznika. Aby usunąć załączony plik – wówczas wybierz przycisk **Usuń plik**.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2



Załączniki

Lp.	Nazwa załącznika	Plik załącznika ⓘ	Status
1	Załącznik testowy	BB1006mB.jpg	Dodano <input checked="" type="checkbox"/>

Dodaj załącznik

⋮

Edytuj nazwę

Usuń załącznik

Usuń plik

Wstecz

Zapisz kopię roboczą

Dalej

28. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** przejdziesz do kroku 5 wypełniania wniosku „**Oświadczenia**”.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

5. Oświadczenia

Oświadczenia

Sposób kontaktu w trakcie realizacji wniosku:

☐ Adres e-mail

☐ SMS

Sposób otrzymania odpowiedzi:

☐ Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie: *

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji wybranych usług elektronicznych udostępnionych w serwisie ŚWITEŻ.

Wstecz

Zapisz kopię roboczą

Dalej

29. Do kontaktu w trakcie realizacji wniosku można wskazać adres e-mail oraz numer telefonu.

30. W przypadku zaznaczenia „Rezygnacji z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej” można wybrać opcję „odbior osobisty” lub „odpowiedź listowana na adres”. W przypadku wyboru opcji listownej należy podać adres.

Oświadczenia

Sposób kontaktu w trakcie realizacji wniosku:

☒ Adres e-mail

Adres e-mail *

kontrola@katowice.gum.gov.pl

☒ SMS

Numer telefonu *

+00322589436

Sposób otrzymania odpowiedzi:

☒ Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

☐ odbiór osobisty

☒ odpowiedź listowna na adres:

Adres *

Rynek 9 Katowice

Oświadczenie: *

☒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji wybranych usług elektronicznych udostępnionych w serwisie ŚWITEŻ.

31. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** przejdziesz do kroku 6 wypełniania wniosku „**Termin realizacji i płatność**”.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

6. Termin realizacji i płatność

Termin realizacji i płatność

Jednostka, w której załatwiasz sprawę

OUM Łódź

ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź

Przybliżony termin realizacji usługi: ⓘ

32. Na kroku „**Termin realizacji i płatność**” istnieje możliwość wyboru innej jednostki realizującej daną usługę.

Szukaj

Q

Jednostka ↕	Miejscowość ↕	Przybliżony termin realizacji ↕
<input type="radio"/> OUM Kraków	Kraków	Nie określono ▾
<input checked="" type="radio"/> OUM Łódź	Łódź	Nie określono ▾

Wstecz

Zapisz kopię roboczą

Dalej

33. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** przejdziesz do kroku 7 wypełniania wniosku „Podgląd”.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2



Podgląd

Jednostka, w której załatwiasz sprawę

OUM Łódź

ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź

Przybliżony termin realizacji usługi:

34. Na tym kroku system prezentuje wszystkie informacje wprowadzone w wyniku uzupełnienia wniosku o ocenę zgodności przyrządów pomiarowych – moduł A2.

Dane wnioskodawcy

Typ wnioskodawcy

Producent

NIP

634-20-28-430

CEIDG

Telefon

Fax

Nazwa podmiotu

ABC Sp.

REGON

KRS

Adres e-mail

interesanteurząd3@gmail.com

Adres stały

Ulica

Jasna

Kod pocztowy

12-456

Skrytka pocztowa

Nr budynku i lokalu

7

Miejscowość

Leszno, woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno

Kraj

Polska

Adres korespondencyjny

Ulica

Jasna

Kod pocztowy

12-456

Skrytka pocztowa

Nr budynku i lokalu

7

Miejscowość

Leszno, woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno

Kraj

Polska

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie

Imię	Nazwisko
Stanowisko/funkcja	Adres e-mail
Telefon	Fax

Dane dodatkowe

Dojazd pracowników Jednostki Notyfikowanej	Uwagi
--	-------

Zgłoszone przyrządy pomiarowe

Nazwa naczynia wyszynkowego	Nazwa handlowa	Model	Material	
Naczynia wyszynkowe z jedną kresą oznaczającą pojemność nominalną, moduł A2	Szklanka	Szklanka	Szkoło	⋮

Załączniki:

Lp.	Nazwa załącznika	Plik załącznika
1	Załącznik testowy	BB1006mB.jpg

Sposób kontaktu w trakcie realizacji wniosku

Nie podano sposobu kontaktu

Sposób otrzymania odpowiedzi

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nie

Oświadczenia RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji wybranych usług elektronicznych udostępnionych w serwisie ŚWITEŻ.

Tak

Wstecz

Zapisz kopię roboczą

Dalej

35. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** przejdziesz do kroku 8 wypełniania wniosku „**Podpis i wystanie**”.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2

Podpis i wysłanie

Uwaga. Dokument przed wysłaniem wymaga podpisania. Proszę użyć jednej z poniższych opcji w celu złożenia podpisu i odblokowania wysyłki dokumentu.

Podpisz Profilem Zaufanym

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu, w którym dokonasz podpisu dokumentu.

[Przejdź](#)

Podpisz certyfikatem kwalifikowanym

Podpis certyfikatem kwalifikowanym to elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Do złożenia podpisu służy aplikacja Comarch INK.

[Podpisz](#)

Przekaż do podpisu innej osobie

Jeżeli dokument wymaga podpisu innej osoby, wygeneruj link za pomocą przycisku poniżej. Następnie skopiuj go i przekaż dalej.

[Generuj link](#)

[Wstecz](#)

[Wyslij wniosek](#)

36. Po wyborze sposobu podpisu jest możliwość podglądu wypełnionego wniosku. W przypadku podpisu profilem zaufanym istnieje konieczność wprowadzenia kodu autoryzacyjnego otrzymanego na telefon.

Potwierdź podpisanie dokumentu

Wpisz poniżej kod autoryzacyjny, który wysłaliśmy na twój telefon

Kod SMS nr 1 z 21.09.2022

Anuluj

POTWIERDŹ

37. Po pozytywnej weryfikacji podpisu otrzymujemy w systemie informację **Podpis poprawny**.



Podpis i wysłanie

Uwaga. Dokument przed wysłaniem wymaga podpisania. Proszę użyć jednej z poniższych opcji w celu złożenia podpisu i odblokowania wysyłki dokumentu.

Podpisz Profilem Zaufanym

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu, w którym dokonasz podpisu dokumentu.

Przejdź

Podpisz certyfikatem kwalifikowanym

Podpis certyfikatem kwalifikowanym to elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Do złożenia podpisu służy aplikacja Comarch INK.

Podpisz

Przełącz do podpisu innej osoby

Jeżeli dokument wymaga podpisu innej osoby, wygeneruj link za pomocą przycisku poniżej. Następnie skopiuj go i przełącz dalej.

Generuj link

Profil Zaufany

Karol Rogacki

Podpis poprawny ✓

Wstecz

Wyślij wniosek

38. Po naciśnięciu przycisku **Wyślij wniosek** system wyświetli poniższą informację.

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2


Wniosek został wysłany

Status sprawy możesz na bieżąco śledzić korzystając z zakładki **Moje sprawy**.
Jeżeli chcesz teraz dokonać płatności przejdź do zakładki **Moje płatności**.


Moje sprawy

Moje płatności

39. Klikając przycisk **Moje sprawy** możesz wyświetlić wszystkie sprawy (wnioski) skierowane przez system Świtez. Wybierając **Moje płatności** system wyświetla informacje związane z opłatami dotyczącymi danych wniosków.
40. Do „Moich spraw” można uzyskać dostęp wybierając z menu „**Moje e-Uслуги**” a następnie „**Moje sprawy**”.

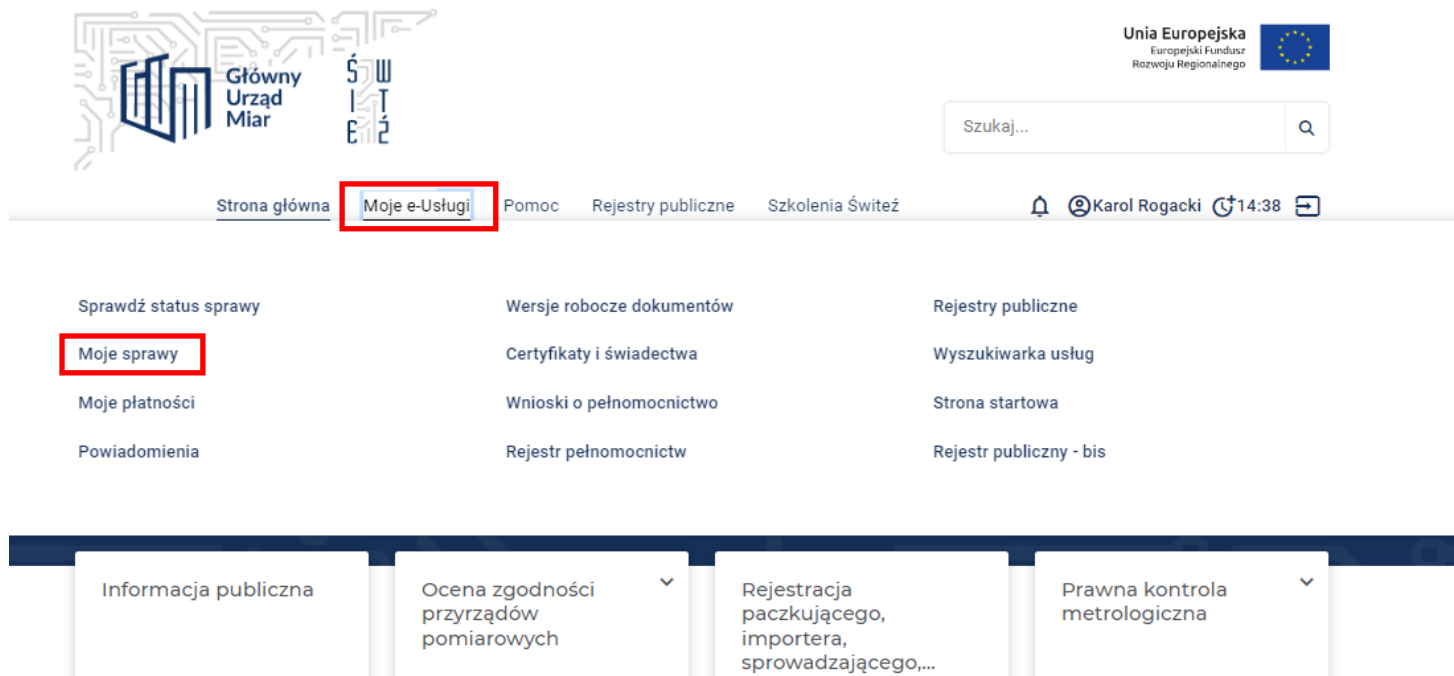

41. Na ekranie zostają wyświetlone wszystkie wnioski przesłane za pośrednictwem systemu.

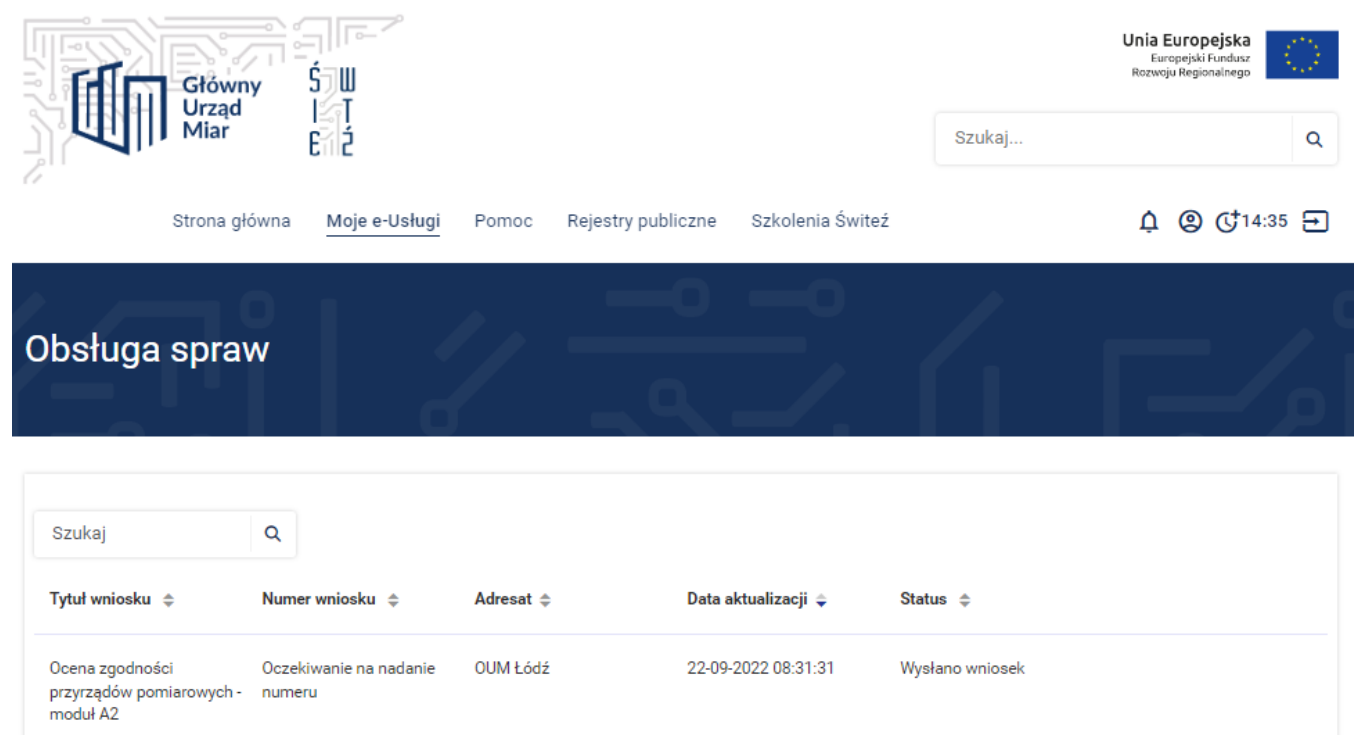

42. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danej sprawy należy wybrać przycisk **Szczegóły**.

Obsługa spraw

Tytuł wniosku	Numer wniosku	Adresat	Data aktualizacji	Status	
Ocena zgodności przyrządów pomiarowych - moduł A2	Oczekiwanie na nadanie numeru	OUM Łódź	22-09-2022 08:31:31	Wysłano wniosek	Szczegóły

43. Po wejściu w **Szczegóły** zostaje wyświetlona historia sprawy.

Obsługa spraw

[← Powrót](#)

Numer wniosku
Oczekiwanie na nadanie numeru

Adresat
OUM Łódź

Doślij dokumenty

Popraw wniosek

Kopiuj jako nowy

Historia sprawy

Data	Status	Wiadomość
22-09-2022 08:31:31	Wysłano wniosek	
22-09-2022 08:31:31	Wysłano dokumenty	▼

Obsługa spraw

← Powrót

Numer wniosku

Oczekiwanie na nadanie numeru

Adresat

OUM Łódź

Doślij dokumenty

Popraw wniosek

Kopiuj jako nowy



Historia sprawy

Data	Status	Wiadomość
22-09-2022 08:31:31	Wysłano wniosek	
22-09-2022 08:31:31	Wysłano dokumenty	
Załączniki		
Wniosek.xml		
BB1006mB.jpg		
UPP.xml		

44. W tym miejscu możesz wybrać następujące opcje **Doślij dokumenty**, **Popraw wniosek** lub **Kopiuj jako nowy**.

45. Należność za usługę można zrealizować kartą płatniczą, gotówką albo przelewem na konto właściwego Okręgowego Urzędu Miar, w którym realizowana była usługa.

46. Chcąc sprawdzić płatności należy z menu wybrać „**Moje e-Uслуги**” a następnie „**Moje płatności**”.



Szukaj...

[Strona główna](#) [Moje e-Uслуги](#) [Pomoc](#) [Rejestry publiczne](#) [Szkolenia Świtez](#) [Karol Rogacki](#) 13:57

[Sprawdź status sprawy](#)
[Moje sprawy](#)
[Moje płatności](#)
[Powiadomienia](#)

[Wersje robocze dokumentów](#)
[Certyfikaty i świadectwa](#)
[Wnioski o pełnomocnictwo](#)
[Rejestr pełnomocnictw](#)

[Rejestry publiczne](#)
[Wyszukiwarka usług](#)
[Strona startowa](#)
[Rejestr publiczny - bis](#)

Płatności użytkownika

Wniosek można opłacić tradycyjnym przelewem lub poprzez płatności elektroniczne wywołane z poziomu portalu. W celu wywołania płatności elektronicznej należy kliknąć w ikonę z trzema kropkami po prawej stronie należności a następnie wybrać odnośnik Zapłać. Aby opłacić wniosek przelewem tradycyjnym należy w tytule przelewu wpisać ID płatności.



ID płatności ⌵

Opis ⌵

Termin płatności ⌵

Płatność ⌵

Zapłacono ⌵

Numer rachunku ⌵

47. Jeśli w trakcie wypełniania wniosku korzystałeś z funkcji **Zapisz kopię roboczą** to są one dostępne w zakładce „**Moje e-Uслуги**” „**Wersje robocze dokumentów**”

[Zapisz kopię roboczą](#)[Dalej](#)

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona główna

Moje e-Uслуги

Pomoc

Rejestry publiczne

Szkolenia Świteż



🧑 Karol Rogacki

🕒 13:57



Sprawdź status sprawy

Moje sprawy

Moje płatności

Powiadomienia

[Wersje robocze dokumentów](#)

Certyfikaty i świadectwa

Wnioski o pełnomocnictwo

Rejestr pełnomocnictw

Rejestry publiczne

Wyszukiwarka usług

Strona startowa

Rejestr publiczny - bis

48. Informacje dodatkowe

Masz możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących realizowanych spraw poprzez trzy kanały: PORTAL, SMS, EMAIL w zależności od rodzaju powiadomienia.

Ustawienia powiadomień

[← Powrót](#)

Powiadomienia Powiadomienia certyfikatów

Szukaj



Tytuł

Kanał

Zgoda

Powiadomienia o certyfikacie/świadczeniu numer U3.OUM07.00000028.2022.S

EMAIL
PORTAL



Powiadomienia o certyfikacie/świadczeniu numer U3.OUM07.00000029.2022.S

PORTAL



Powiadomienia o certyfikacie/świadczeniu numer U3.OUM07.00000034.2022.S

EMAIL
PORTAL



Powiadomienia o certyfikacie/świadczeniu numer U3.OUM07.00000033.2022.S

EMAIL
PORTAL



Powiadomienia o certyfikacie/świadczeniu numer U3.OUM07.00000035.2022.S

PORTAL
EMAIL



Powiadomienia o certyfikatach i świadectwach

PORTAL



W edycji powiadomienia można ustawić sposób powiadomienia wg potrzeb. Powiadomienia o certyfikatach i świadectwach ustawione są domyślnie w systemie ŚWITEŻ. W edycji powiadomienia możesz dokonać zmiany jego ustawień. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Dostęp do ustawień Powiadomień i ich zarządzanie możliwy jest w systemie ŚWITEŻ bezpośrednio poprzez wybór zakładki **Ustawienia powiadomień** albo w sekcji funkcjonalnej na stronie systemu.